EBOOK
STEP-BY-STEP

S-CAPEPOD

TELO DI EVACUAZIONE

BUDGET MODEL

Creato da Tetcon

s-capepod®
THE EVACUATION SOLUTION

Questa è la guida per imparare l'uso sicuro del Modello Budget S-CAPEPOD

Il Modello Budget S-CAPEPOD è un telo di evacuazione che viene sistemato sotto il materasso del letto.
Permette di evacuare rapidamente le persone allettate in caso di emergenza.

Prima di utilizzare S-CAPEPOD Modello Budget

Queste istruzioni contengono informazioni sull'uso sicuro dell'S-CAPEPOD. Per garantire un uso corretto e sicuro del telo di evacuazione, è necessario leggere le informazioni contenute nel presente manuale prima di posizionare e utilizzare l'S-CAPEPOD. Chiunque si appresti ad utilizzare il dispositivo deve aver letto attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e deve inoltre comprendere le informazioni contenute. È responsabilità dell'utente agire in modo sicuro e corretto. Questo vale sia per il paziente che per gli operatori. Il presente manuale descrive l'uso dell'S-CAPEPOD in un contesto ideale e può essere considerato solo come una linea guida.

Consigli sull'addestramento/formazione

In questo manuale si spiega come utilizzare l'S-CAPEPOD Modello Budget con una sola persona. Per una formazione interna si consiglia di utilizzare il telo di evacuazione con due persone. In questo modo si ridurrà lo stress fisico e la possibilità di lesioni per voi ed i vostri collaboratori.

Specifiche Tecniche

CE

Nr. Articolo:	5083210000
Nome del Modello:	S-CAPEPOD Evacuation Sheet - Budget Model
Dim. sotto materasso:	205 x 78 cm | 81.88" x 30.7"
Adatto per materassi:	Larghezza: 80-90 cm / 31" - 38" | Max. Lunghezza: 210 cm / 82" 800
Peso:	gr / 1.76 lbs
Materiale:	100% poliestere (ignifugo&antibatterico)
Classificaz. Resist. Fuoco:	M1 /EN597
Trattam. Antibatterico:	Sanitized® TH 27-24
Carico di lavoro sicuro:	120-150 kg/264-330 lbs (dipende dalle dimensioni)
Istruz. per il lavaggio:	Utilizzare un sacchetto di lavaggio. Temperatura di lavaggio, max. 40 gradi, asciugare a bassa temperature, non stirare, non pulire con prodotti chimici, non candeggiare, non usare detersivi con ammorbidenti.
Garanzia:	un anno di garanzia, a partire dalla data di fatturazione, sui difetti di confezionamento e di fabbricazione

Contatti

Per qualsiasi domanda sul prodotto e sul suo utilizzo, rivolgersi al fornitore local. Accertarsi sempre di disporre della versione corretta del manuale.

Informazioni sull'Azienda

Tetcon Global BV
Johannes Buijslaan
20 5652 NK
Eindhoven Paesi
Bassi

www.tetcon-ge.com
www.s-capeplus.com

Email: info@tetcon-ge.com
Telefono: +31 40 298 9955

Tetcon. All rights reserved. S-CAPEPOD® is an official registered trademark by Tetcon Global B.V. in The Netherlands.

Terminologia

Prima di iniziare questa semplice guida step-by-step, è bene chiarire i termini utilizzati in questo manuale.

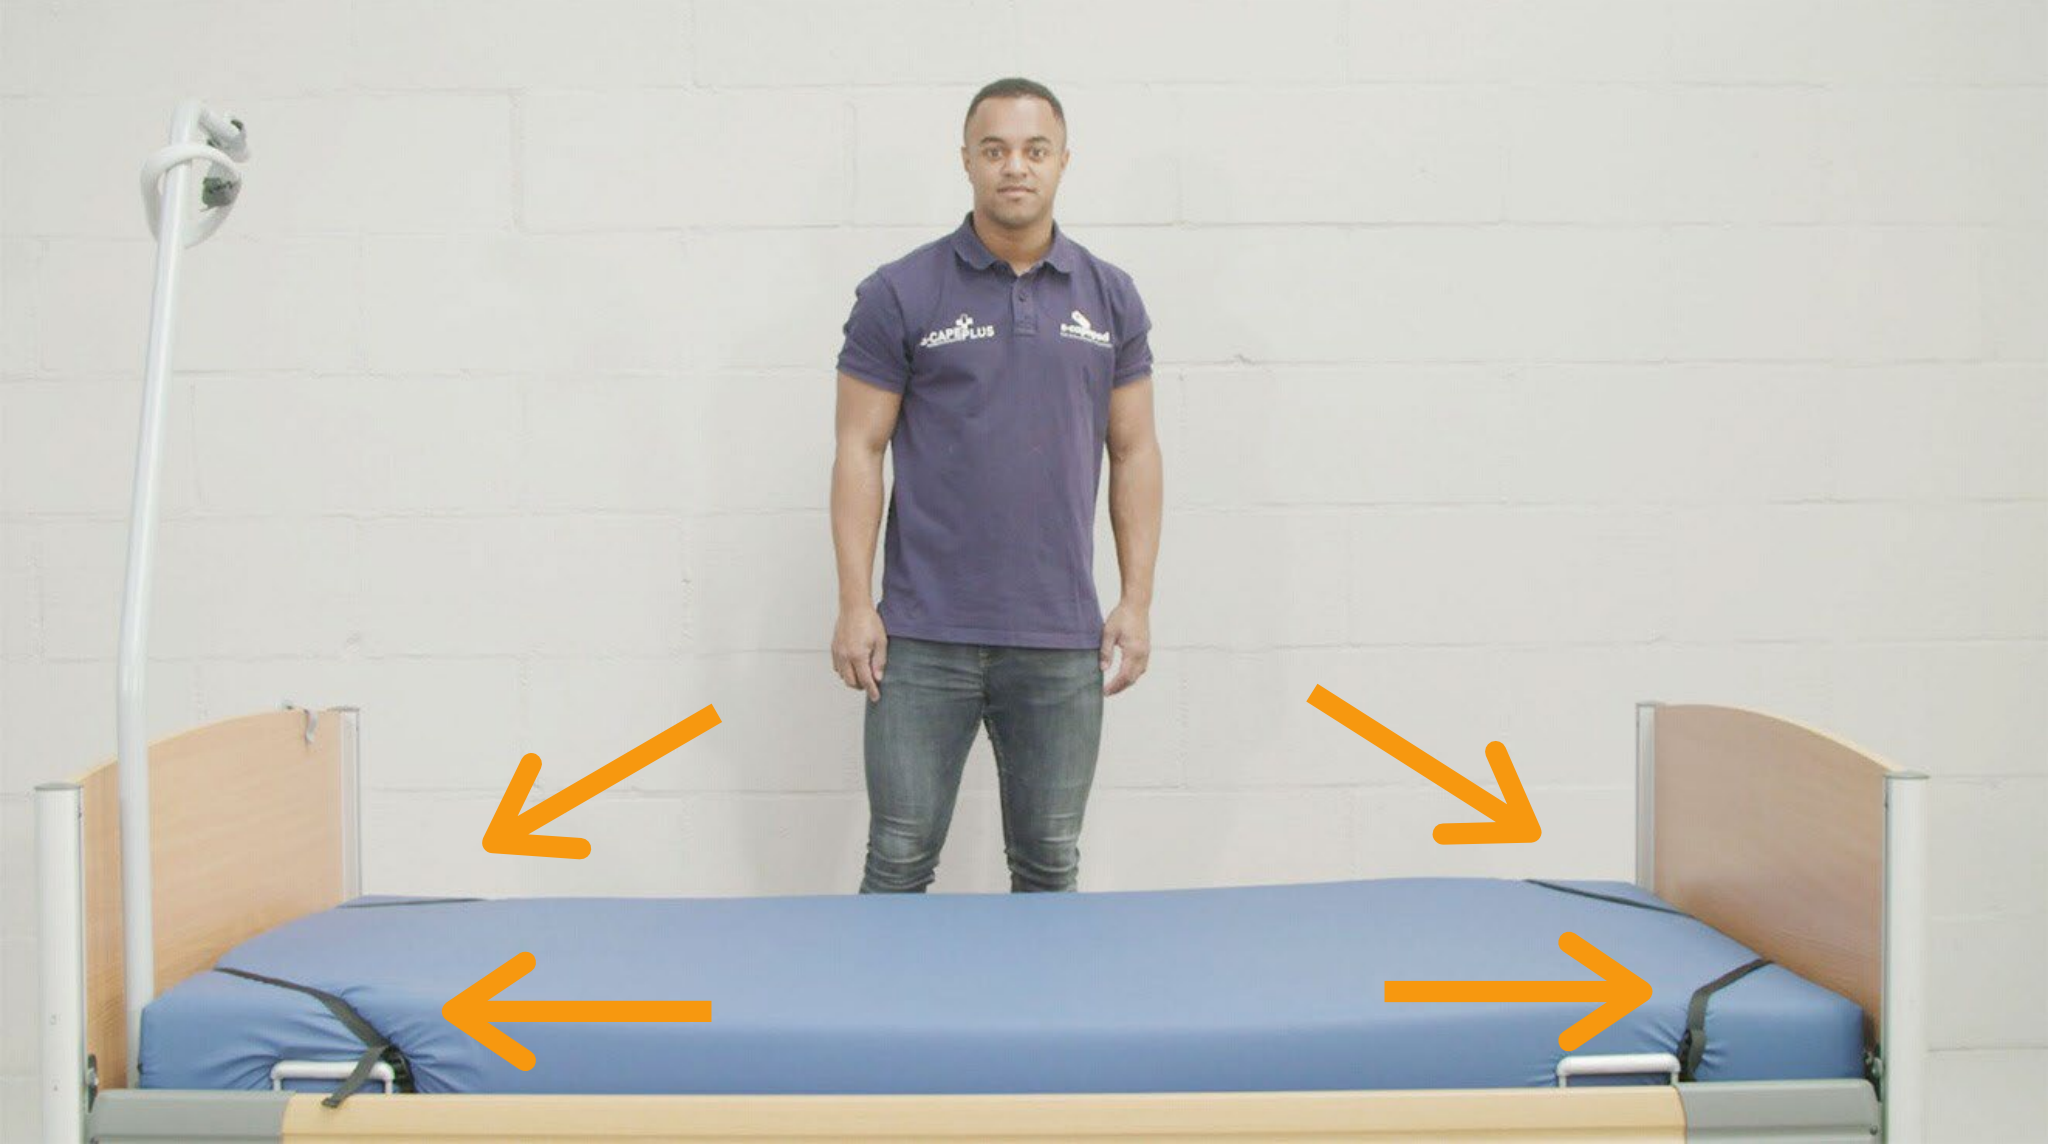

Step 1

Posizionare il Modello Budget S-CAPEPOD Budget Model sul letto.
Usare le 4 cinghie di regolazione per fissare il telo S-CAPEPOD – Modello Budget sul materasso.

Step 2

Per posizionare l’S-CAPEPOD bisogna sempre iniziare dal lato destro (visto dal lato dei piedi). Sollevare quindi il materasso.

Step 3

Inserire il dito nell’occhiello della cinghia trasversale.

Step 4

Tirare quindi la cinghia verso di sè.

Step 5

Ora è possible sganciare la seconda cinghia trasversale.
Si possono sgangiare anche simultaneamente.

Step 6

Posizionare le cinghie trasversali sopra il paziente. Se necessario, è possibile posizionare un cuscino sopra le cinghie per migliorare il comfort del paziente.

Step 7

Inserire la cinghia attraverso l’anello.

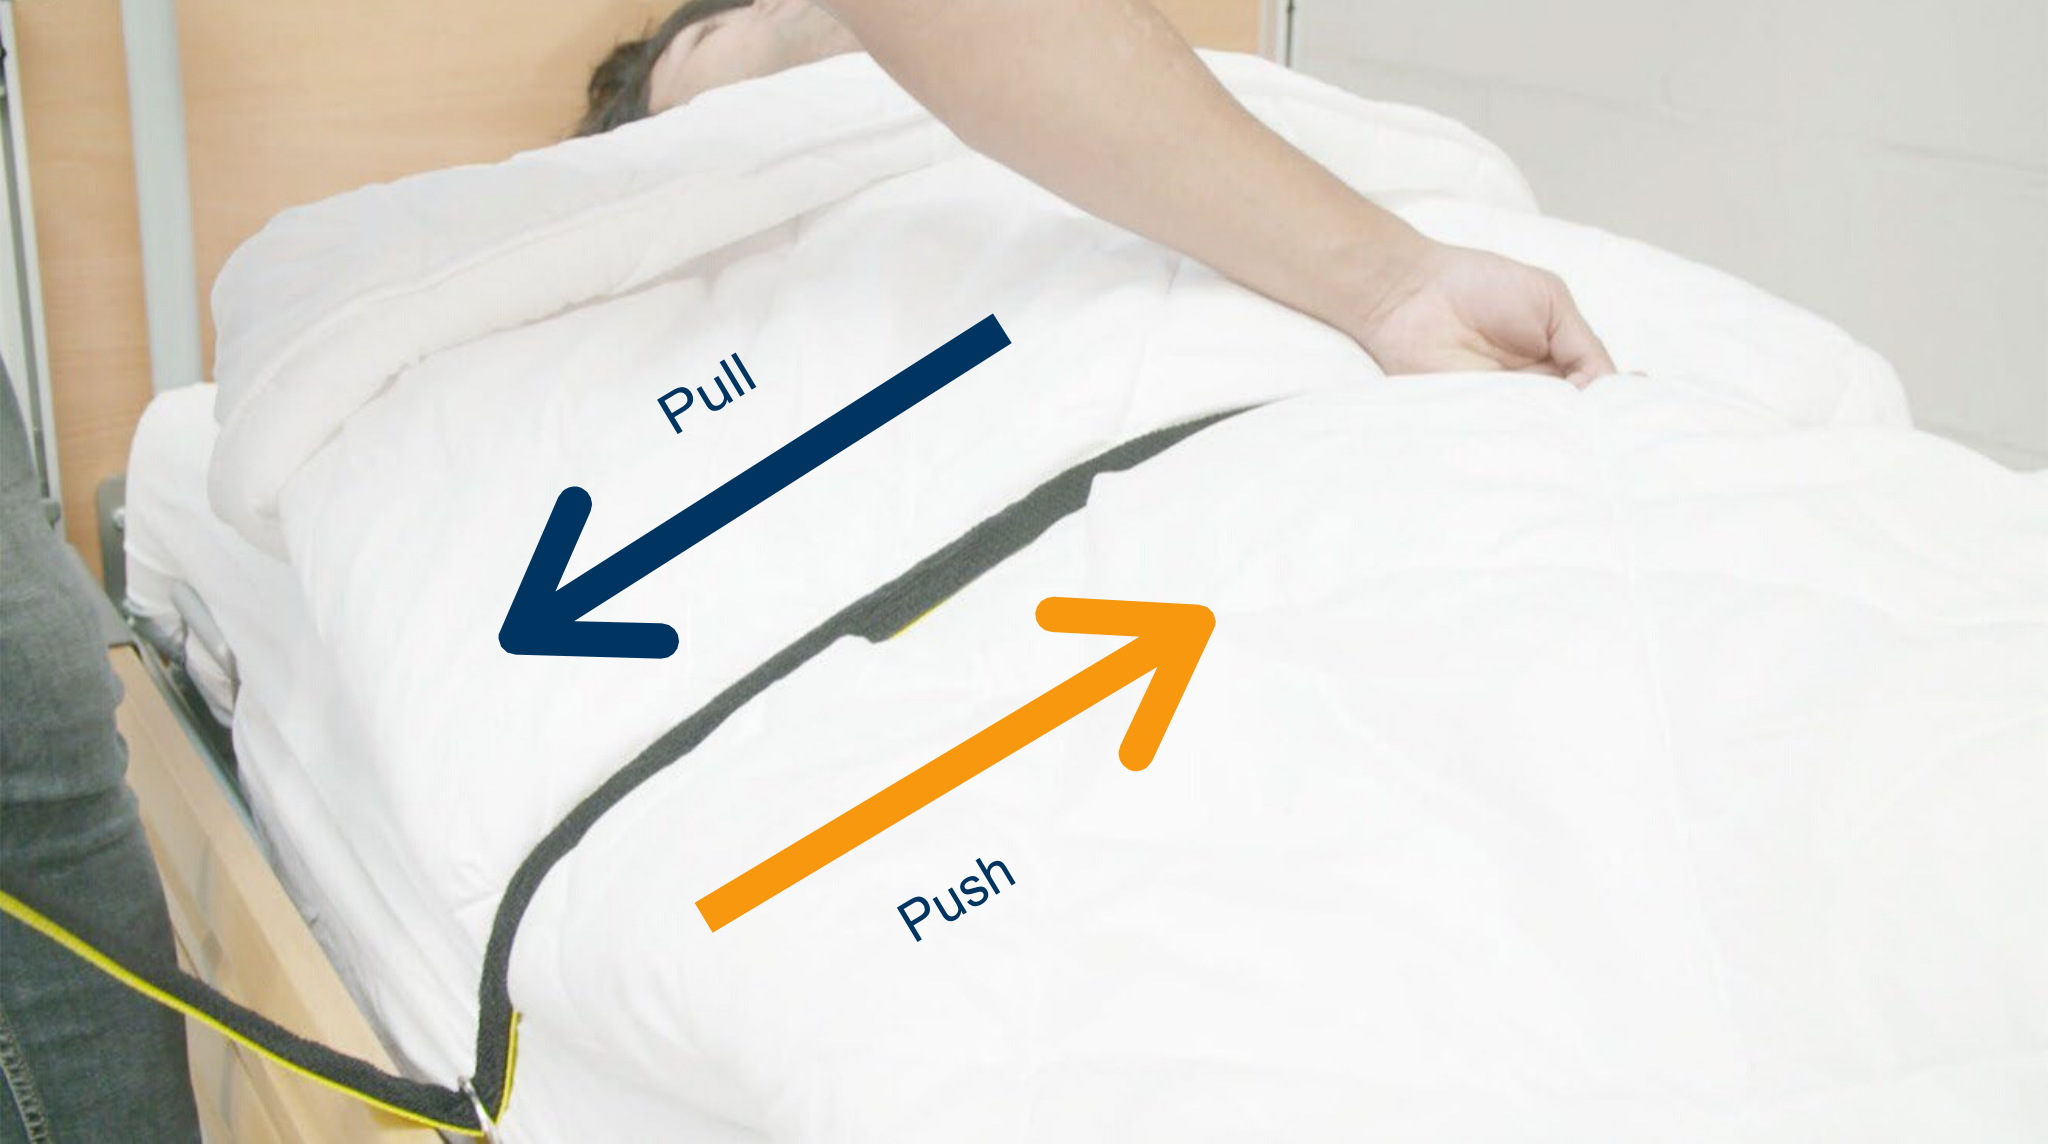

Step 8

Ora chiudere bene la cinghia con i ganci e gli occhielli. Tirare e spingere contemporaneamente.

Step 9

Stringere le cinghie per creare una leggera forma a ‘U’ con il materasso.

Step 10

Adesso è possibile evacuare il paziente.

Step 11

Rilasciare la cinghia di trazione dalla tasca all’estremità dei piedi.

Step 12

Girare il paziente sul letto. Afferrare saldamente la cinghia di trazione sul lato dei piedi.

Step 13

Tirare il paziente verso di sè. Prima di abbassare il paziente, accertarsi che i suoi glutei superino il bordo della struttura del letto.

Step 14

Adesso abbassare il materasso a terra e tirare fino a un punto di sicuro.

Step 14

Incaso di lesioni al collo o alla testa, è possibile rimuovere il paziente dal letto anche in senso inverso. Afferrare saldamente la cinghia di trazione all’estremità della testa, girare il paziente sul letto e tirare verso di sè. Abbassare il materasso a terra e tirare verso un punto sicuro.

Informazioni sulla Sicurezza

- Quando si utilizza l'S-CAPEPOD, attenersi sempre alle istruzioni riportate nel manuale di istruzioni.
- Utilizzare l'S-CAPEPOD solo in caso di emergenza, come ad esempio un incendio, un'interruzione di corrente, una fuga di gas, un attacco terroristico, una catastrofe naturale, fumo estremo o qualsiasi altra situazione di pericolo per la vita o di emergenza.
- Un posizionamento errato dell' S-CAPEPOD tra la struttura del letto e il materasso può influire negativamente sull'efficacia del dispositivo. Pertanto, attenersi sempre scrupolosamente alle istruzioni riportate nel foglio illustrativo.
- L'uso di alcolici e/o farmaci da prescrizione o da banco può influire negativamente sull'abilità del soccorritore che tira l' S-CAPEPOD.
- Non rimuovere alcuna parte dell' S-CAPEPOD.
- Assicurarsi che le informazioni sulla sicurezza e il manuale di istruzioni siano conservati vicino al letto in cui si trova il dispositivo.
- Questo S-CAPEPOD non è destinato a un uso ricreativo.
- Non utilizzare vapori, materiali o liquidi infiammabili come benzina, alcol, ecc in prossimità dell'S-CAPEPOD.
- La mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale di istruzioni fornito con S-CAPEPOD può causare gravi lesioni fisiche o addirittura la morte.
- Spigoli o sporgenze taglienti possono danneggiare S-CAPEPOD e quindi a ridurre l'efficacia del prodotto.
- Esercitarsi a utilizzare l'S-CAPEPOD almeno una volta all'anno per garantirne l'uso corretto e sicuro in caso di emergenza.
- Contattare i vari servizi di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze ecc.) per informarli dell'acquisto e della presenza dell' S-CAPEPOD.
- S-CAPEPOD non è adatto per essere utilizzato vicino a fiamme libere.
- Dopo l'uso, l'S-CAPEPOD deve essere accuratamente controllato per verificare l'assenza di danni. Se si riscontrano, il prodotto non deve essere riutilizzato. Inoltre, il dispositivo deve essere ripiegato e riposto ogni volta dopo l'uso.
- Se il prodotto viene posizionato tra la struttura del letto e il materasso e non viene utilizzato per un'evacuazione di emergenza, assicurarsi che le cinghie ai piedi e alla testa del letto siano ben chiuse.
- Per motivi igienici, l'S-CAPEDPOD deve essere pulito regolarmente. Sempre lavare il prodotto separatamente e seguire le istruzioni di lavaggio.
- S-CAPEPOD ha una garanzia di un anno per difetti di materiale e di fabbricazione, valida a partire dalla data di acquisto. Il produttore potrebbe Richiedere una prova della data di acquisto. Si raccomanda pertanto di conservare la fattura in un luogo sicuro. Guasti o prblemi legati all'utilizzo del prodotto come risultato di incidenti, uso improprio e non corretto, manutenzione o amministrazione non corrette, nonchè manutenzione normale e ordinaria non effettuata non sono coperti da garanzia.
- Il produttore non è responsabile per I danni conseguenti e dervanti dall'uso di S-CAPEPOD.